

令和 6 年度

物 品 購 入 設 計 書

岩手中部水道企業団

企業長	副企業長	局 長	課 長	課長補佐	係 長	設計者	精算者			
着手	期 日		自 令和 年 月 日			適 要	上段：当初設計 下段：変更設計			
完了			至 令和 7年 2月 28日							
番 号		第 号								
納 入 場 所		岩手中部水道企業団 危機管理センター								
件 名		高圧蒸気滅菌器更新								
設 計 金 額		金 [redacted] 円也								
購 入 内 容		別紙のとおり								

仕 様 書

1 品 名 高圧蒸気滅菌器

2 仕 様

1. 外寸法 : 600W×700D×1100H mm の大きさを超えないこと。
2. 缶内容量 : 有効内容量が50L以上であること。
3. 圧力容器の種別 : 小型圧力容器
4. 扉の設置向き : 処理物を投入するための扉は上開きタイプであること。
5. 処理温度範囲 : 105～130℃の範囲内で設定できること。
6. 滅菌時間 : 1～60分の範囲内で設定できること。(残時間表示方式)
9. 保温温度範囲 : 45～60℃の範囲内で設定できること。
10. 保温時間 : 0～48時間の範囲で設定できること。
11. 予約タイマー : 1時間後～72時間後の範囲で設定できること。(運転開始時間設定方式)
12. 運転プログラム : 処理温度、時間、保温温度の条件を任意に設定でき、その運転プログラムを4種類以上保存できること。
13. 本体 : 本体は、長期間の使用に耐えられるような素材であること。
14. 圧力計 : 圧力計を有し、その表示範囲は0～3MPaの範囲を示すことができること。
15. 安全装置など : 缶内圧力が一定圧力を超えた場合、自動的に滅菌工程を中止し、強制排気すること。缶内に圧力がある場合には扉が開かない安全装置を有し、運転終了後に自動的に残留圧力を排気させる機能を有すること。
緊急停止スイッチを有すること。
19. 冷却ファン : 処理物冷却のための冷却ファンを有していること。
20. 表示 : 操作するために必要な表示はすべて日本語表記であること。
21. 電源 : 電源容量は100V20A以内とし、納入時に電源への接続を行うこと。
22. 付属品 : 下記のものを付属すること。
金属カゴ 2個
排水ボトル 1個
キャスターストップパー 1式

3 納 入 条 件

1. 機器の搬入及び設置を含む。設置が完了した後速やかに試運転を行い、機器が正常に稼働することを確認すること。また、担当者等に機器の扱いに必要な説明、指導を行うこと。
2. 搬入及び設置作業中、納入者に起因する事故が発生した場合、付随する損害は納入者が

その責を負わなければならない。


3. 納入した機器に関して、1年以内に発生した不具合については、監督者の指示に従い無償にて修理、交換等必要な措置を行うものとする。ただし、納入者に責任が無いことが明確な場合はこの限りではない。
4. 納入の際は、事前に納入予定日時等を監督者と十分協議のうえ、指示する場所に設置すること。

4 その他

1. 設置後、梱包材等は引き取ること。なお旧装置は含まない。
2. 旧装置は、監督者の指示する場所に移動させること。
3. 設置の各段階において作業を記録し報告書に添付すること。

5 参考機種

- ・アドバンテック東洋株式会社 STH364FA

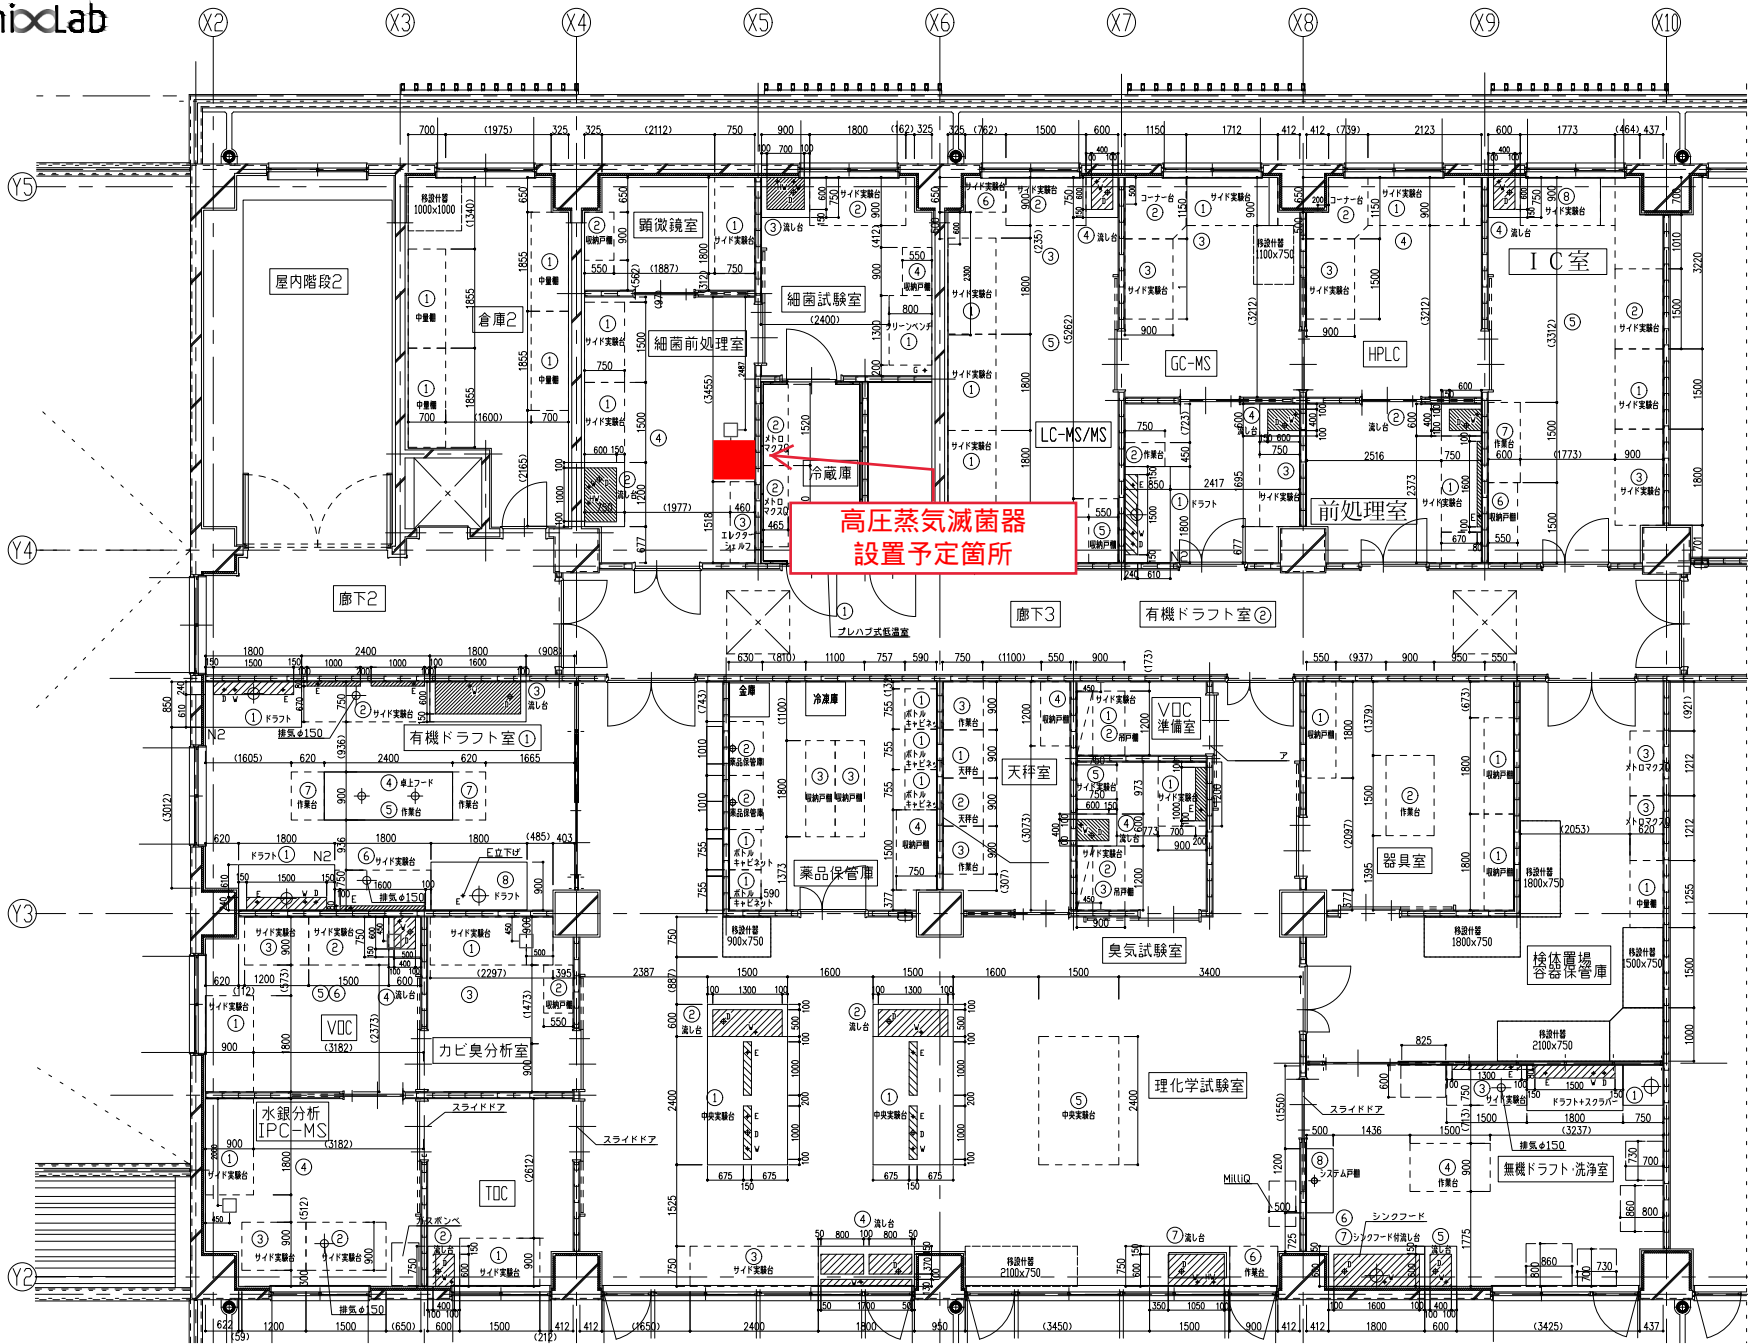

△22/01/27	レイアウト変更
△21/11/05	レイアウト変更
△20/10/19	レイアウト変更、配管立上り位置追加(木田)
△20/09/16	レイアウト変更
日付	訂正欄

特記	担当	検図	設計	作図
			○	○

岩手中部水道企業団危機管理センター		発行日	整理
名称 レイアウト図		縮尺	図番
		A3	1/100
		御中	計
			REV. 0